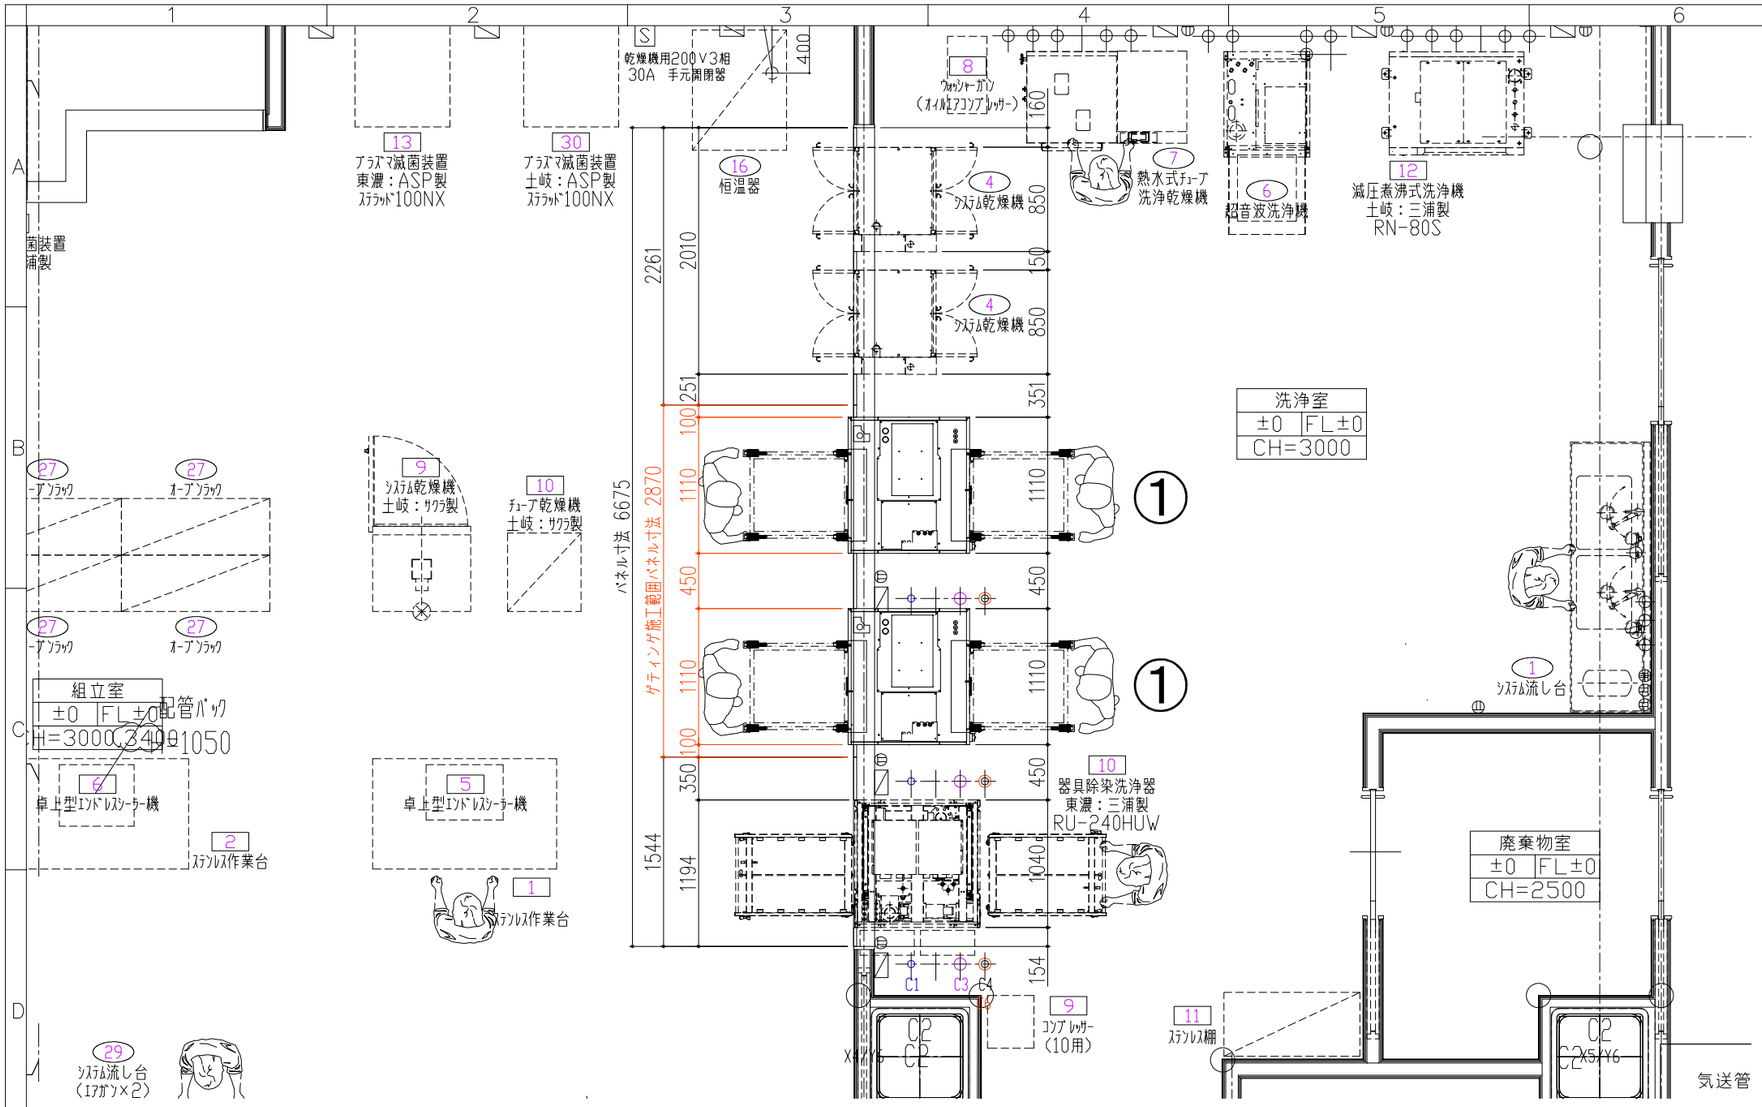

設置機器

No	名　　称	型　　式	数量	重量kg 上段：装置重量 下段：運転時重量	発熱量kw 設置室内	発熱量kw パネル前面（扉閉時） 上段：ダーティ側 下段：クリーン側	発熱量kw パネル前面（扉開時）	備　　考
①	ウォッシャーディスインフェクター	WD8668EW	2	485 687	1.5	1.1 0.06	1.1	

※数値は機器1台当たりです

① WD8668EW 標準必要設備（一次側工事）

給水	20A	SGP(ライニング)	立下り FL+2300mm	ねじ込みバルブ止め	給水圧:0.2～0.6MPa	消費量30L/min
給湯	20A	SGP(ライニング)	立下り FL+2300mm	ねじ込みバルブ止め	給湯圧:0.2～0.6MPa	消費量30L/min　給湯温度60℃以下
RO水	20A	SUS	立下り FL+2300mm	ねじ込みバルブ止め	給水圧:0.2～0.6MPa	消費量30L/min
高温排水	50A	SGP(白鋼管)	立上り FL+ 65mm	キャップ止め	背圧が無いこと	排水量40L/min　排水温度90℃
排気ダクト	φ150	SUS	立下り CH- 100mm	切り放し	背圧が無いこと	排気風量250CMH 湿熱排気温度Max90℃
電源	三相 200V 17.8kw 60A			ELB（30mA）止め		

日付	備考	日付	備考	お客様承認欄
				日付　／／

GETINGE
ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

尺度	A3 S=1:50			
社内使用欄				
承認	製図	確認	確認	

Title
東濃中部医療センター　様
中央材料室ご提案機器レイアウト図　パネル割

作成年月日	PJ No.
2025/06/26	1144
図面番号	Rev.
K-23L0064-02	